COLOQUICK

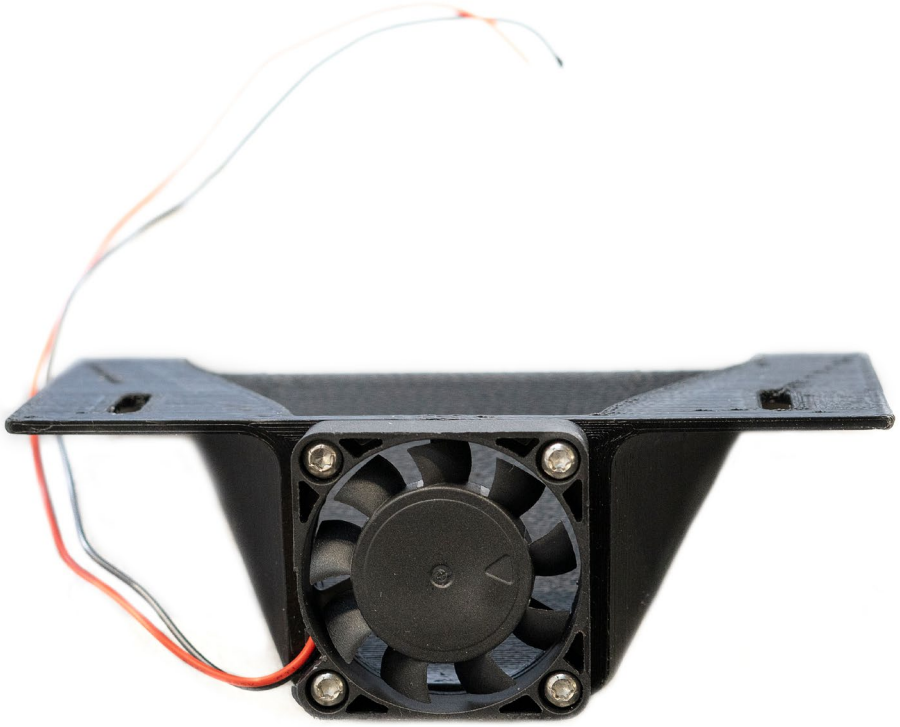

MANUAL FOR INSTALLING
DEHUMIDIFIER UPGRADE

ES

GN-T-DUG0002-ES

Índice

Herramientas necesarias 2
Procedimiento y precauciones de seguridad 2
Guía de procedimiento 3

Procedimiento y precauciones de seguridad

Este manual es una guía para instalar el deshumidificador en el descongelador ColoQuick 1.5.

Tenga cuidado al colocar la unidad de ventilación, ya que si la aprieta demasiado puede romper el plástico.

ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA ESTÉ APAGADA. ¡DEBE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL!

- Los niños y las mascotas no deben dejarse sin supervisión con el ColoQuick. Tenga especial cuidado cuando la cubierta y/o la puerta de servicio estén abiertas.
- Existe riesgo de descarga eléctrica cuando la puerta de servicio está abierta. Sólo debe ser abierto por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.

Herramientas necesarias

- **Destornillador torx tamaño 10**
- **Llave de estrella tamaño 7**
- **Llave de estrella tamaño 10**
- **Llave hexagonal tamaño 2.5**
- **Destornillador tamaño 3**

Guía de procedimiento

1. Coloque la unidad DESCONGELADORA a una altura ideal para facilitar el acceso.

2. Retire las tuercas para desbloquear la puerta de servicio.

3. Abra la puerta de servicio para acceder a la caja negra.

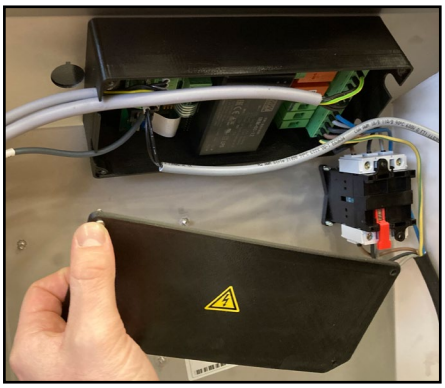

4. Quite los cuatro tornillos y quite la cubierta negra de la caja.

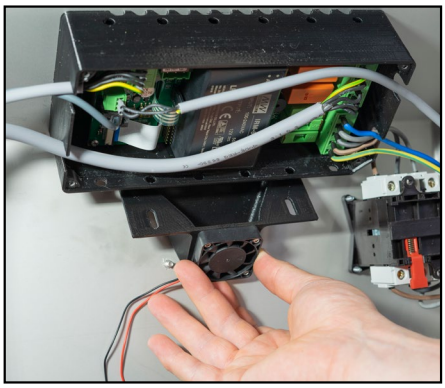

5. Sostenga la unidad del ventilador detrás de la caja negra, con el ventilador hacia usted y los orificios para los tornillos hacia arriba.

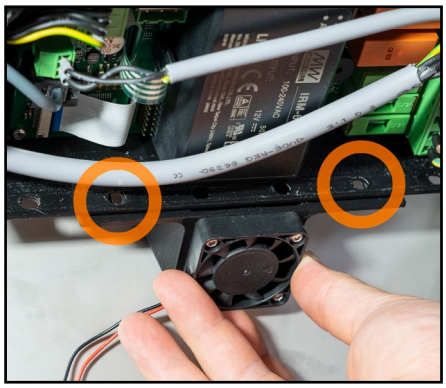

6. Alinee los agujeros de los tornillos en la unidad del ventilador con los agujeros en la caja negra. **Asegúrese de empujar la unidad del ventilador lo más atrás posible.**

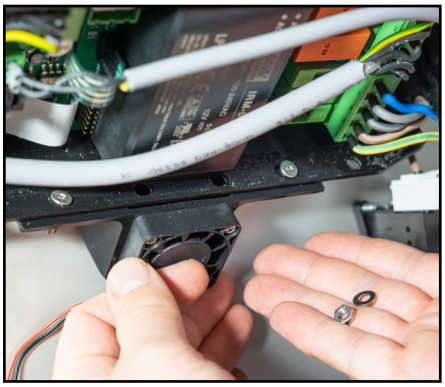

7. Monte los dos tornillos. Pon un tornillo en cada esquina. Prepare las arandelas y las tuercas.

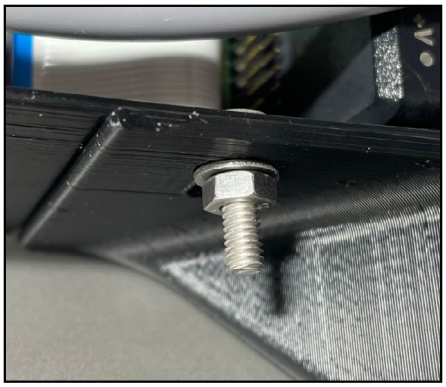

8. Mientras empuja el conjunto del ventilador hacia atrás tanto como sea posible, monte una arandela y una tuerca para cada tornillo. ¡TENGA CUIDADO DE NO APRETAR DEMASIADO!

9. Localice el conector verde en la parte superior de la tarjeta. ¡CUIDADO PARA ELEGIR EL CONECTOR CORRECTO!

Guía de procedimiento

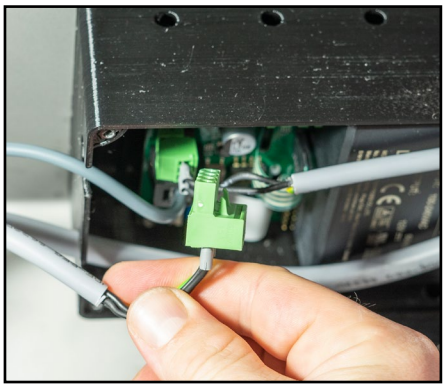

10. Retire el conector verde tirando con firmeza. Asegúrese de tirar de él en línea recta, de lo contrario, los pines de la placa podrían dañarse.

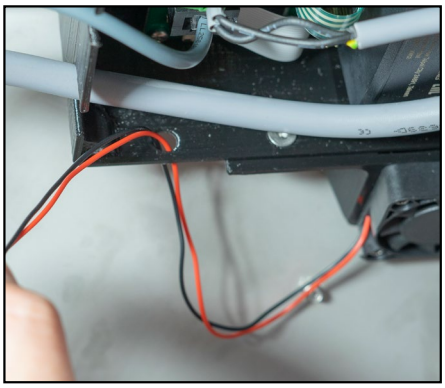

11. Pase los cables del ventilador a través del orificio más a la izquierda de la caja, entrando desde la parte posterior.

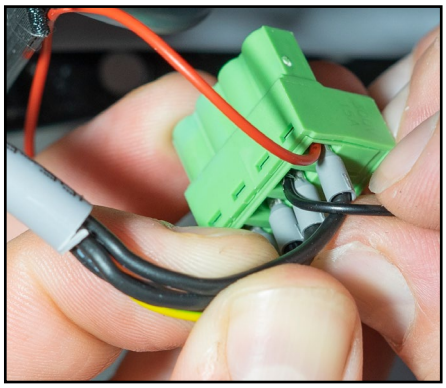

12. Suelte los dos cables más alejados del cable amarillo/negro. Luego inserte el cable rojo de la unidad del ventilador en la posición más a la derecha y el cable negro al lado.

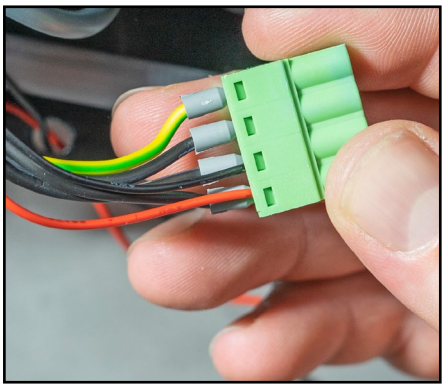

13. Después de insertar los cables de la unidad de ventilación, apriete los tornillos. El resultado debe verse como se muestra arriba.

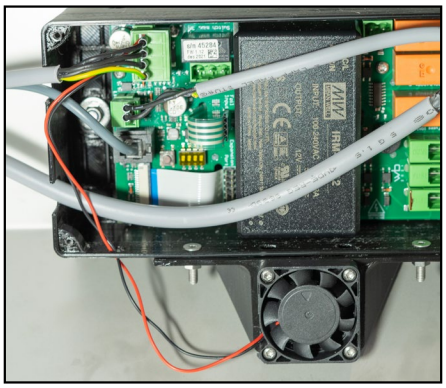

14. Vuelva a colocar el enchufe verde en el tablero.

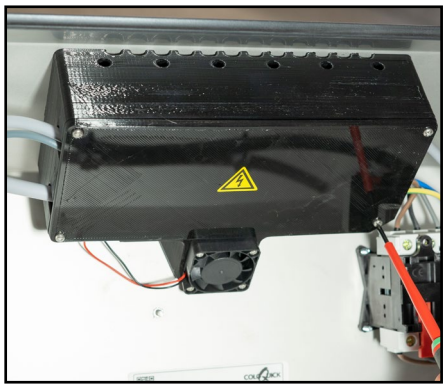

15. Vuelva a apretar la tapa de la caja negra. Tenga cuidado de no apretar demasiado. Encienda la máquina brevemente para comprobar que el ventilador funciona y, a continuación, apáguela de nuevo.
PRECAUCIÓN MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÁ ENCENDIDA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

16. Cierre la tapa y coloque las tuercas para bloquear la puerta de servicio.

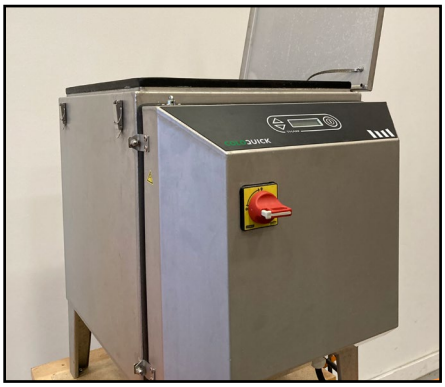

17. La operación ha terminado y la unidad DESCONGELACIÓN está lista para usar.

Si tiene duda, por favor contáctenos:

ColoQuick
Tel: +45 9753 7333
Email: info@ColoQuick.com

ES

GN-T-DUG0002-ES